

Wika Polska sp. z o.o. sp. k.

Inspection certificate according to EN 10204 – 3.1
Certificat d'étalonnage selon EN 10204 – 3.1



Customer:
Client: HYTORC LOCATION
179 RUE DE MONTEPY
69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE
FR

Page 2 / 2
Page


Certificate No. WC018492
Certificat N°

Date 26.02.2021
Date

Result
Résultat

Temperature 20°C +/- 5 K
Température

Test Item Candidat bar	Standard Référence bar	Meanvalue Moyenne bar	rel. Deviation rel. Ecart bar	Deviation Ecart %	Hysteresis Hystérésis %
0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
2,000	2,033	2,002	-0,017	-0,17	-0,30
4,000	4,030	4,028	-0,029	-0,29	-0,02
6,000	5,998	5,969	0,016	0,16	-0,29
10,000	9,981	9,981	0,019	0,19	0,00

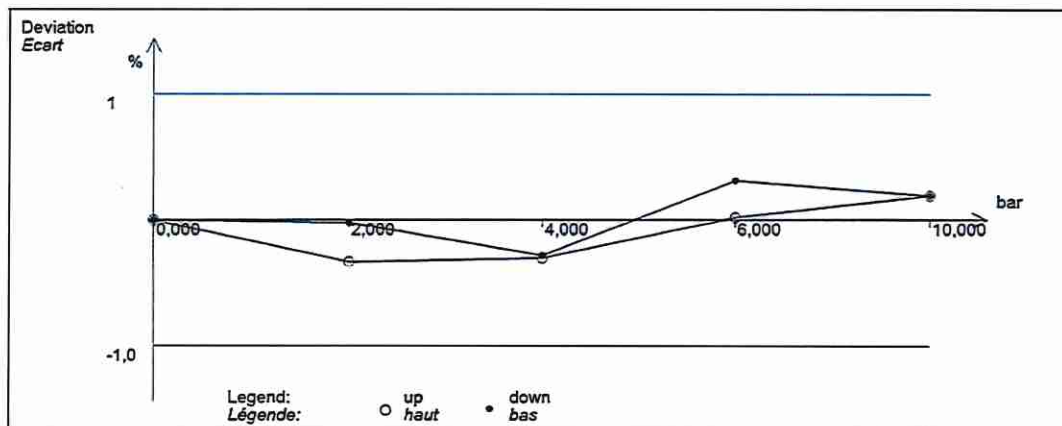

Object keeps the specification.

L'objet conserve ses caractéristiques.

Calibration was carried out according to the following norm:
L'étalonnage a été réalisé selon la norme suivante:

DIN EN 837-1

Mise en service par David
HUSTACHE le 04/09/2023

Remarks / Extension:

Inspection Representative (GA)
Spécialiste Ralf Gross

Examiner
Examineur

S. Piekarski

This document was created automatically and needs no signature.
Etabli automatiquement, pas de signature requise

Wika Polska sp. z o.o. sp. k.

Inspection certificate according to EN 10204 – 3.1
Certificat d'étalonnage selon EN 10204 – 3.1



Page 1 / 2
Page

Customer:
Client: HYTORC LOCATION
179 RUE DE MONTEPY
69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE
FR

Certificate No.
Certificat N° WC018492

Date
Date 26.02.2021

Customer Order No. N° commande client	19563	Customer Part. No. N° d'article du client	48789539	Order Date Date de commande	16.04.2021
Order No. / Item N° de commande	CC420939/2 32992549	Part No. N° d'article	48789539		
Model Type	213.53.100	Serial number Numéro de série	5403PCIP	Scale range étendue d'échelle	0 ... 10 bar rel.
Class Classe	1,00 %	Tag No. Etiquette n°			
Reference Référence	CPG2500 0,01% IS-50 -1 ... 32,1 bar rel.			Calibration No. N° de calibrage	SW-201-1-20 WPL 20-10
Article text Texte de l'article	Bourdon tube pressure gauges, liquid filling,				

Mise en service par David HUSTACHE le 04/09/2023